

# ERGOWAVE® Montage- und Einstelltipps

## Sattelhöhe


Standardsattel



SQlab ERGOWAVE®




SQlab ERGOWAVE® R



Beachten Sie, dass die SQlab ERGOWAVE® Sättel 60X, 611 und 612 durch die erhöhte Sitzfläche höher aufbauen können.

## Sattelneigung

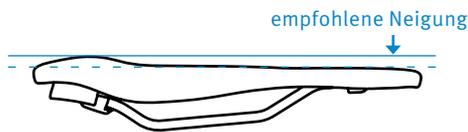


Die Ausgangsposition ist eine waagrechte bis ganz leicht nach oben zeigende Sattelnase.  
Zur Erhöhung des Fahrkomforts an den Sitzknochen kann die Nase leicht nach oben zeigen.  
Bei spürbarem Druck im Dammbereich die Sattelnase leicht absenken.

## Sattelversatz


Standardsattel

Sitzknochenauflage

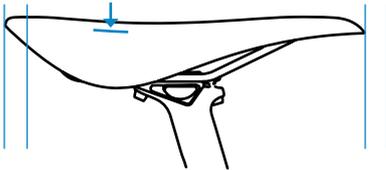


SQlab ERGOWAVE®

Sitzknochenauflage

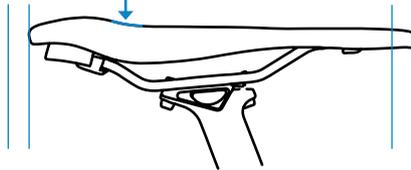

SQlab ERGOWAVE® R

Sitzknochenauflage

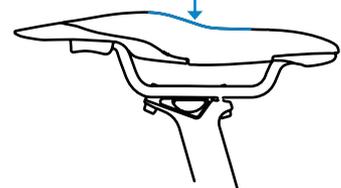

SQlab ERGOWAVE® active Sättel sollten etwas weiter nach vorne geschoben werden als herkömmliche Sättel.

Wichtig ist, dass die Sitzknochen bei den ERGOWAVE® Modellen auf der mittleren Stufe, an der breitesten Stelle des Sattels aufliegen.

Es empfiehlt sich eine Sattelstütze ohne Versatz.

Für den Versatz des 613R lässt sich keine allgemeine Aussage treffen, da sich Rahmengeometrien und Sattelstützen im Triathlon stark voneinander unterscheiden.

## Klemmung



Der Sattel muss stets innerhalb des markierten Klemmbereiches montiert werden.

Der Sattel sollte innerhalb der Klemmung niemals ganz nach hinten geschoben werden. Die große Hebelwirkung kann die Streben beschädigen.

Achten Sie auf das vom Hersteller der Sattelstütze angegebene Drehmoment.

Die Klemme sollte außerdem mindestens 32 mm lang sein.

Bitte beachten Sie zur Montage und zur Benutzung Ihres SQlab Produkts unbedingt die im Internet zur Verfügung gestellte Bedienungsanleitung.



# ERGOWAVE® Adjustment Advice

## Saddle height


Standard saddle



SQlab ERGOWAVE®



SQlab ERGOWAVE® R



Please note: the SQlab ERGOWAVE® saddles 60X, 611 and 612 can build up higher due to the raised seat surface.


## Saddle slope




Begin by positioning the saddle nose horizontally or pointing slightly upward.  
The nose can be sloped slightly upwards for increased comfort.  
If pressure is felt in the perineal area, lower the saddle nose slightly.

## Saddle fore & aft positioning


Standard saddle

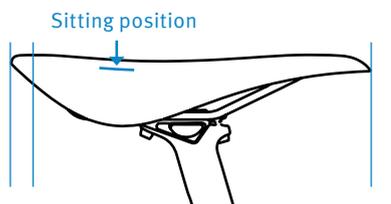

SQlab ERGOWAVE®

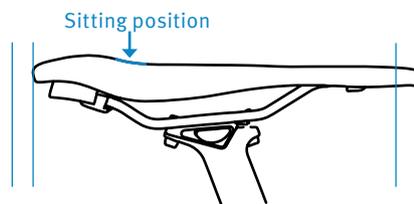

SQlab ERGOWAVE® R

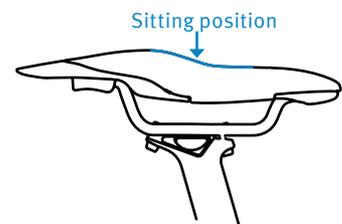

SQlab ERGOWAVE® active saddles should be mounted slightly further forward than conventional saddles.

It is important that the seat bones of the ERGOWAVE® models rest on the middle step, at the widest point of the saddle.

A seat post without offset is recommended.

No general statement can be made for the offset of the 613R, since frame geometries and seatposts in triathlon differ greatly from each other.

## Saddle clamp



The saddle must always be mounted within the marked clamping area.

The saddle should never be pushed all the way back inside the clamp. The large leverage effect can damage the rails.

Pay attention to the torque specified by the seatpost manufacturer.

The clamp should also be at least 32 mm long.

Please follow the operating instructions provided on the Internet for the installation and use of your SQlab product.



# ERGOWAVE® montage- & insteltips

## Hoogte van het zadel


Standaard zadel



SQlab ERGOWAVE®




SQlab ERGOWAVE® R



Let erop dat de SQlab ERGOWAVE® zadels 60X, 611 en 612 kunnen hoger oplopen door het verhoogde zitvlak.


## Hellingshoek van het zadel

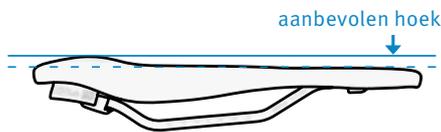


De uitgangspositie voor een comfortabele zit is een horizontaal geplaatste zadelneus.  
Als dat lekkerder zit, dan kan de zadelneus eventueel ook iets naar boven wijzen.  
Als je druk voelt op en rond het perineum, kan je de zadelneus iets laten zakken.

## Verticale positionering van het zadel


Standaard zadel

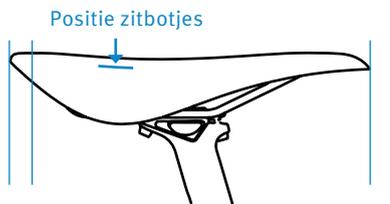

SQlab ERGOWAVE®

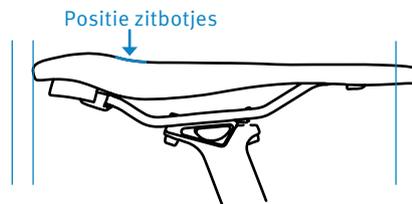

SQlab ERGOWAVE® R

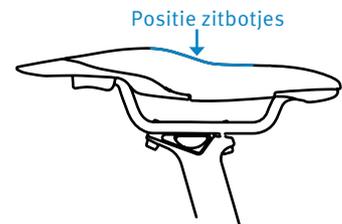

SQlab ERGOWAVE® active zadels moeten iets verder naar voren worden geschoven dan conventionele zadels.

Het is bij de ERGOWAVE® modellen belangrijk dat de zitbotjes op de middelste trede rusten, op het breedste punt van het zadel.

We raden aan zadelpennen met een rechte kop te gebruiken, dus zonder offset (= zonder buiging naar achteren).

Er kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de offset van de 613R, aangezien framevormen en zadelpennen in de triatlon sterk van elkaar verschillen.

## Bevestiging van het zadel



Het zadel moet altijd binnen het aangegeven klembereik worden gemonteerd.

De zadelpenklem mag nooit helemaal voorin het onderstel geplaatst worden! Vanwege de grote hefboom kan het onderstel beschadigen.

Let op het door de fabrikant van de zadelpen gespecificeerde aanhaalmoment.

De klem moet daarbij ten minste 32 mm lang zijn.

Let bij de montage en het gebruik van uw SQlab-product altijd op de gebruiksaanwijzing op internet.



# ERGOWAVE® Conseils de montage

## Hauteur de la selle


Selle standard



SQlab ERGOWAVE®




SQlab ERGOWAVE® R



Notez que les selles SQlab ERGOWAVE® 60X, 611 et 612 peuvent monter plus haut grâce à leur assise surélevée.


## Inclinaison de la selle

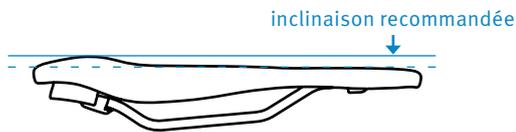


La position de départ est un nez de selle horizontal ou très légèrement pointé vers le haut.  
Pour augmenter le confort de conduite au niveau des os du siège, le nez peut être légèrement orienté vers le haut.  
En cas de pression perceptible dans la région du périnée, abaisser légèrement le nez de la selle.

## Décalage de la selle

Selle standard

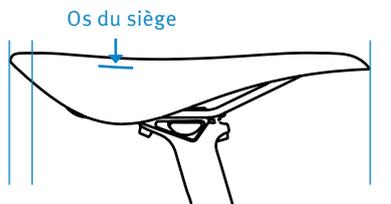

SQlab ERGOWAVE®

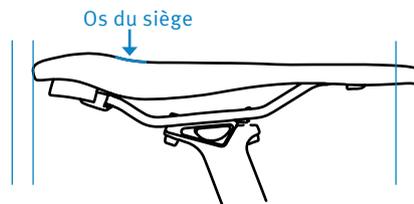

SQlab ERGOWAVE® R



Les selles SQlab ERGOWAVE® active doivent être poussées un peu plus vers l'avant que les selles traditionnelles.

Il est important de noter que sur les modèles ERGOWAVE®, les os du siège reposent sur le niveau intermédiaire, à l'endroit le plus large de la selle.

Il est recommandé d'utiliser une tige de selle sans déport.

Il n'est pas possible de faire une déclaration générale pour le déport du 613R, car les géométries de cadre et les tiges de selle sont très différentes en triathlon.

## Pince



La selle doit toujours être montée dans la zone de serrage marquée.

La selle ne doit jamais être poussée complètement vers l'arrière à l'intérieur du dispositif de serrage. L'effet de levier important peut endommager les entretoises.

Veillez à respecter le couple de serrage indiqué par le fabricant de la tige de selle.

Le collier de serrage doit également mesurer au moins 32 mm de long.

Pour l'installation et l'utilisation de votre produit SQlab, veuillez suivre les instructions d'utilisation fournies sur Internet.

